



Vue isométrique
Echelle : 1:1

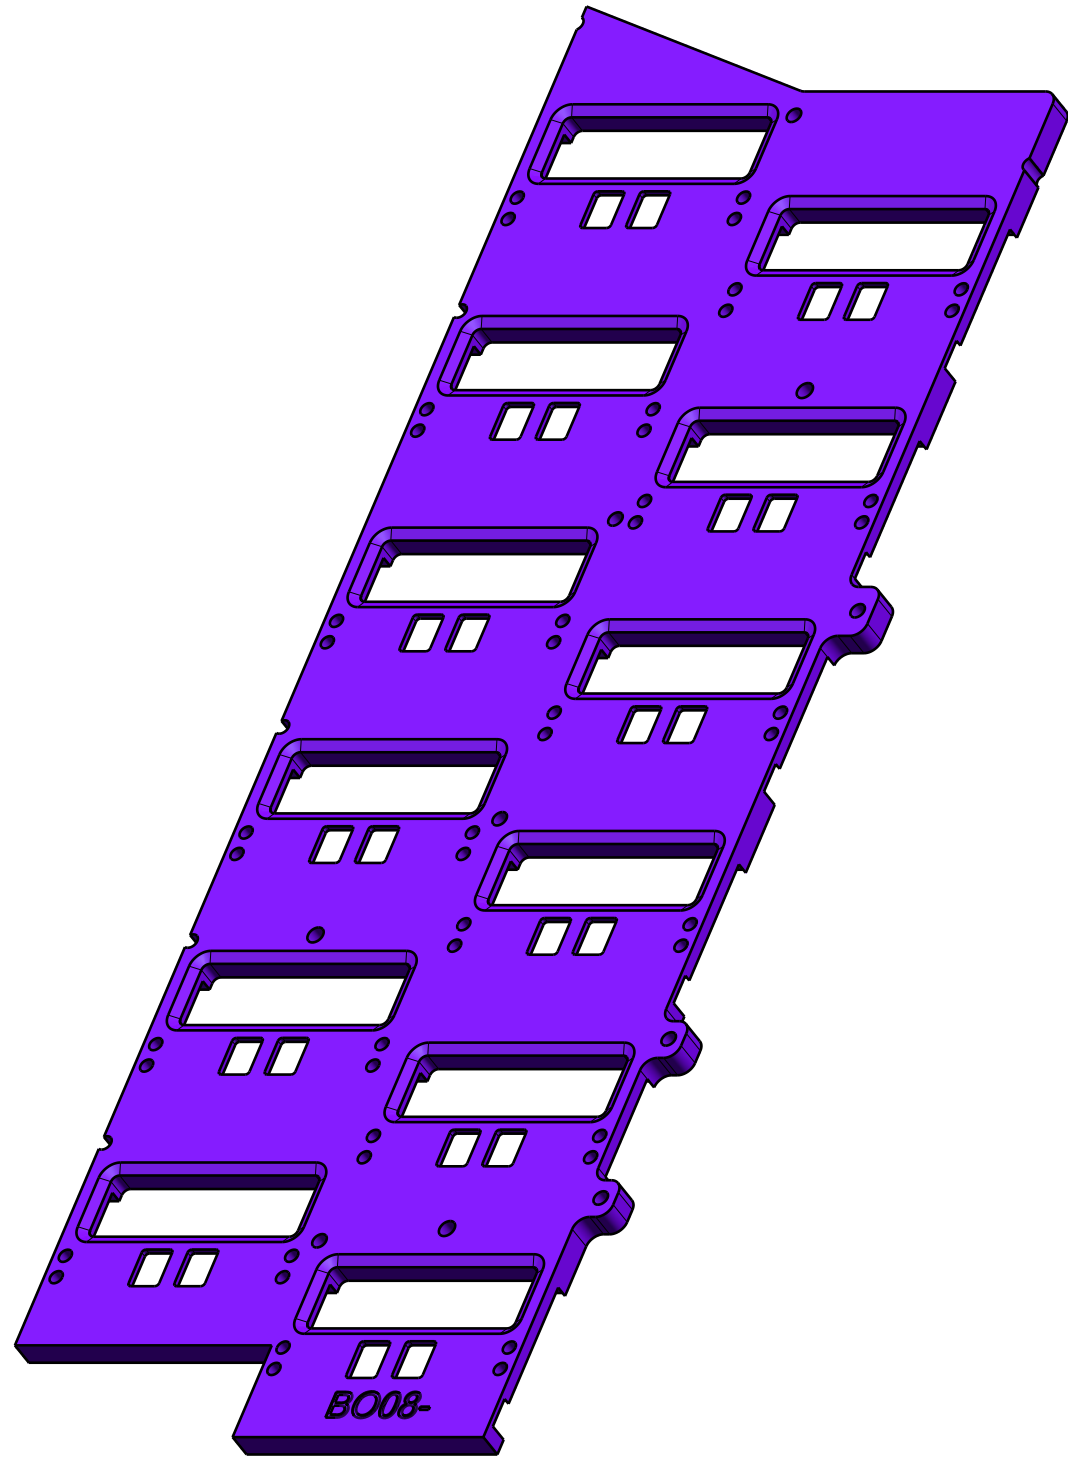

Vue isométrique
Echelle : 1:1

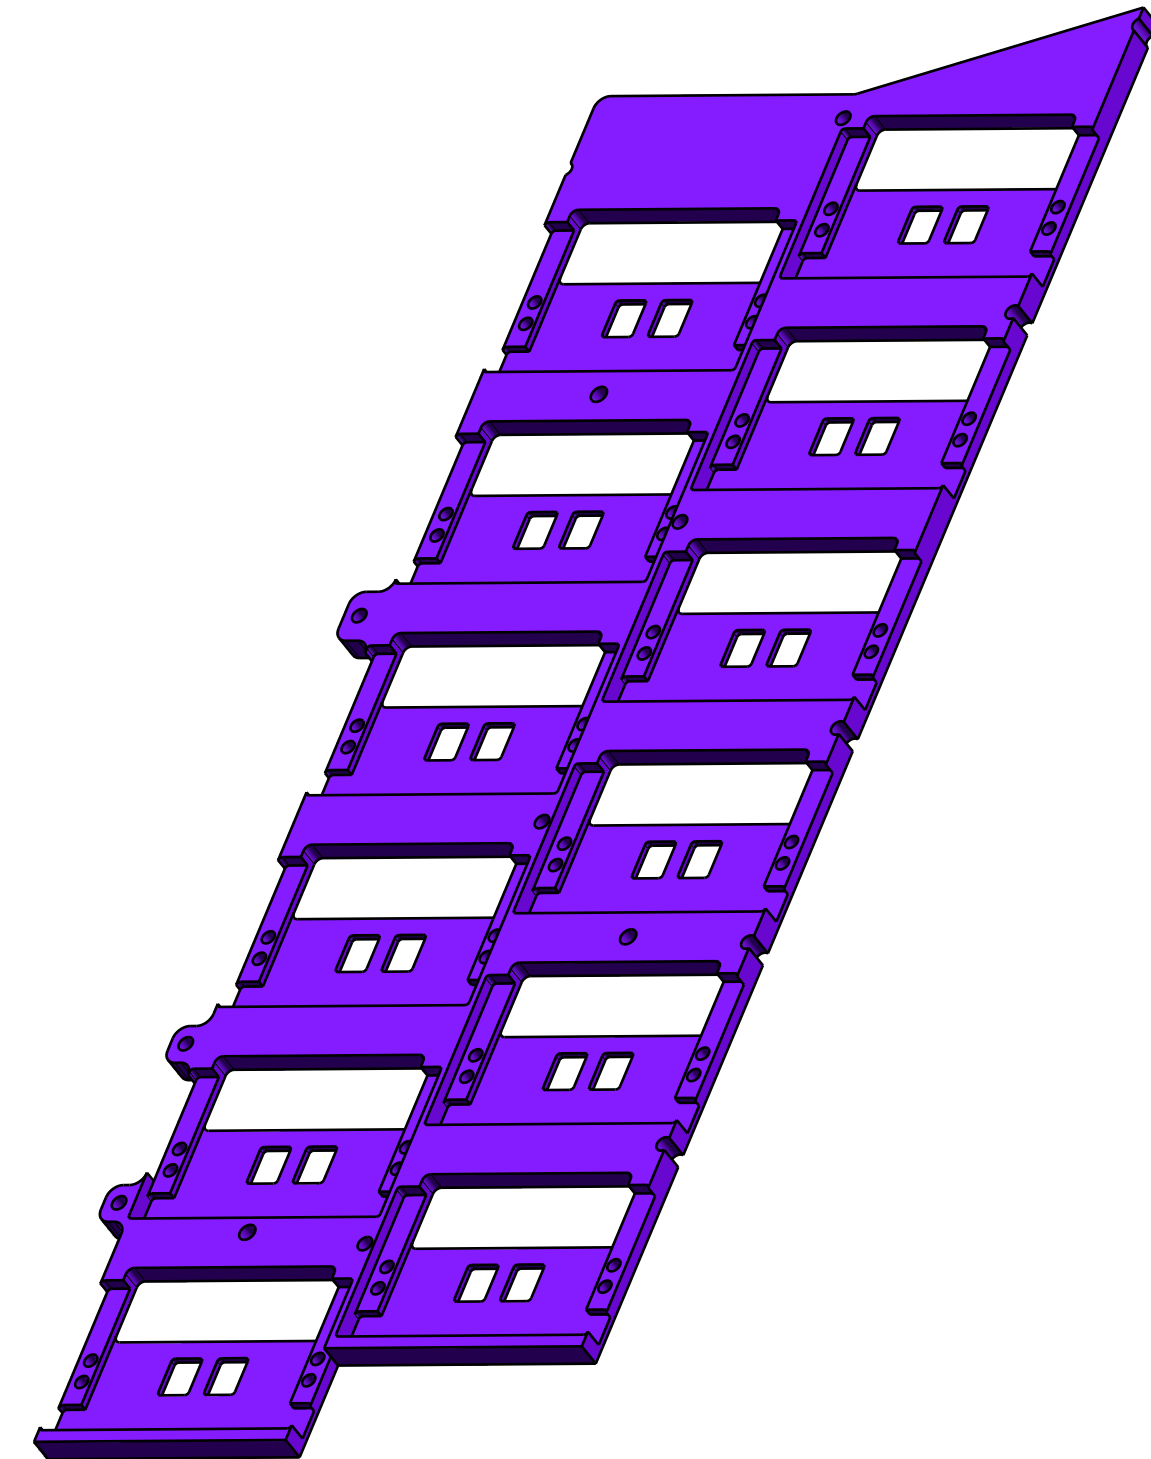

Vue de derrière
Echelle : 1 :1


ØM3 ▽ Traversante \ through

REF.	X	Y
A	-20	2
B	-20	139
C	22	50


13x Ø 2.2 H10 $\left(\begin{smallmatrix} +0.04 \\ 0 \end{smallmatrix} \right)$ (E)

REF.	X	Y
1	0	0
2	-43	7
3	-43	33
4	0	69
5	-44	103
6	2	118
7	-41	176
8	1	184
9	43	199
10	42	152
11	42	84
12	42	49
13	42	16


B

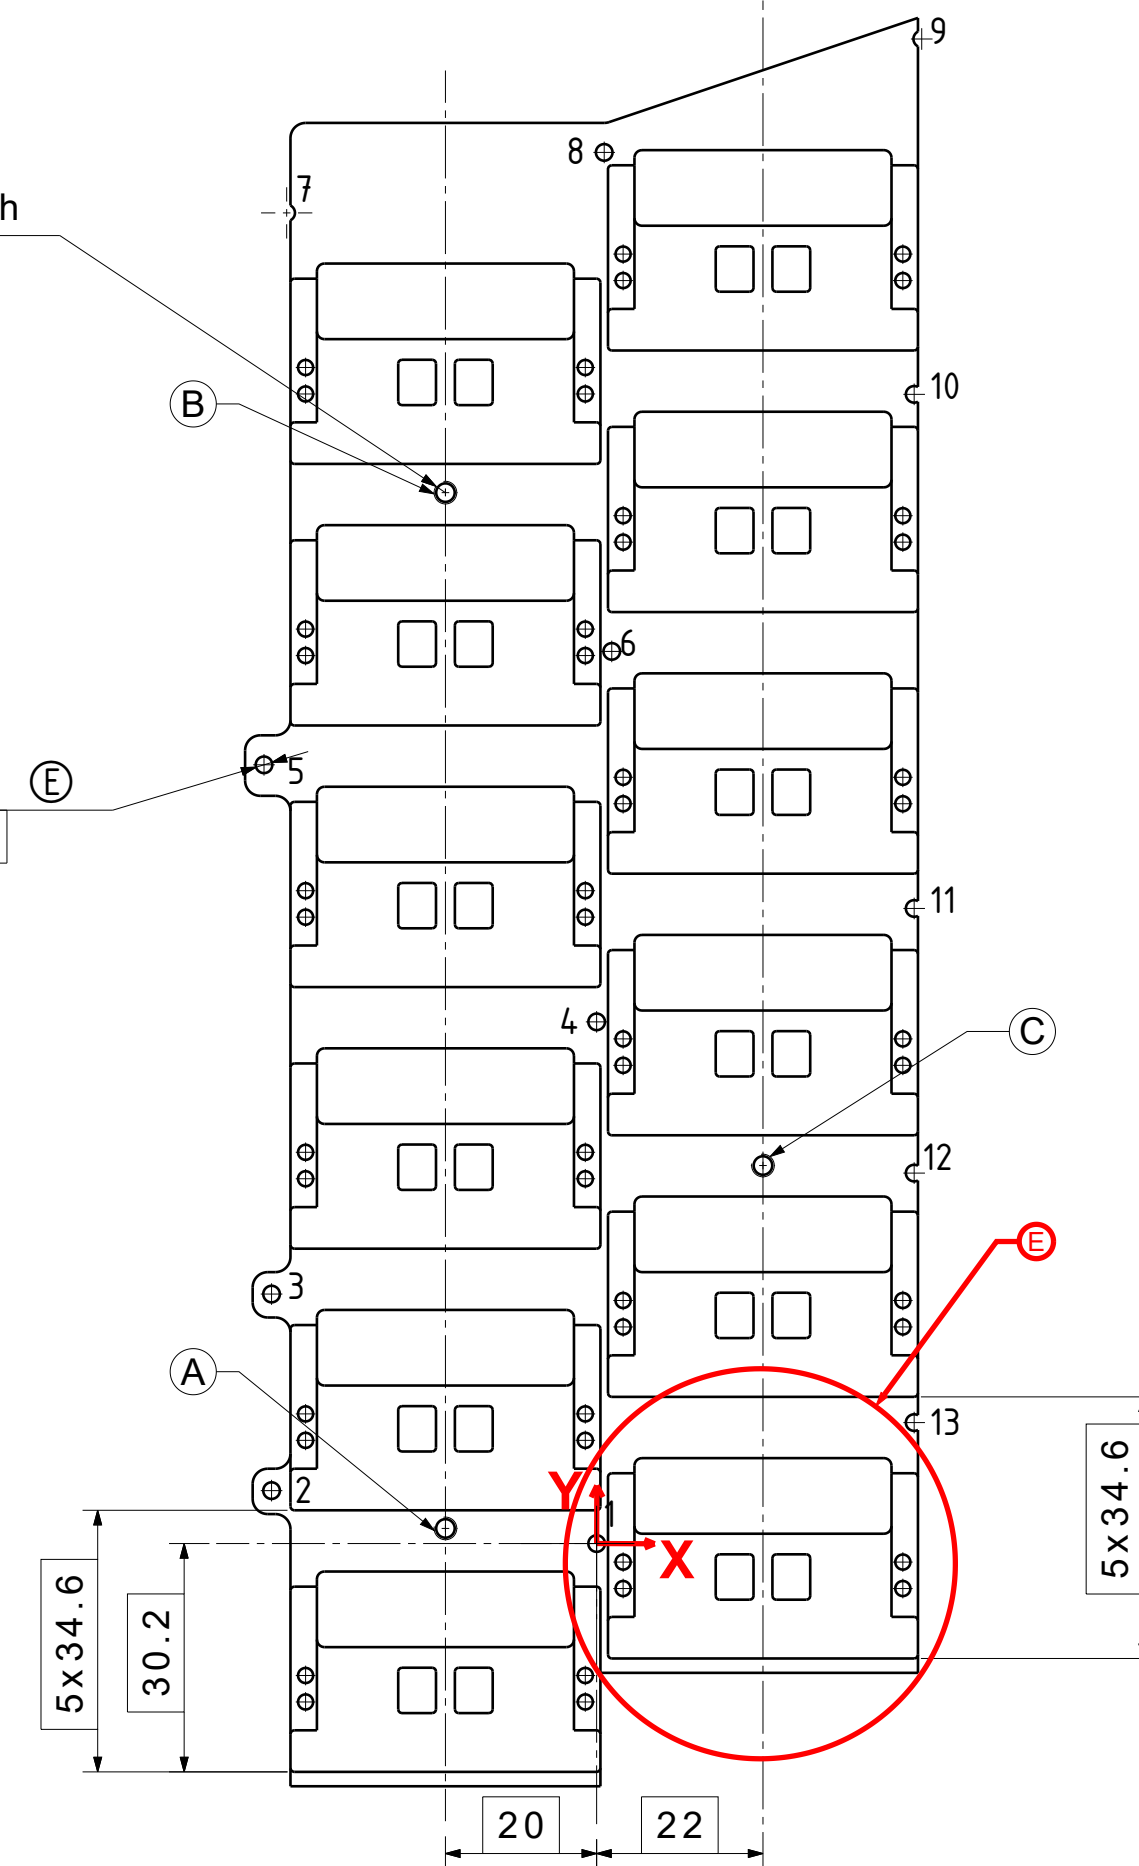


Vue de droite
Echelle : 1:1

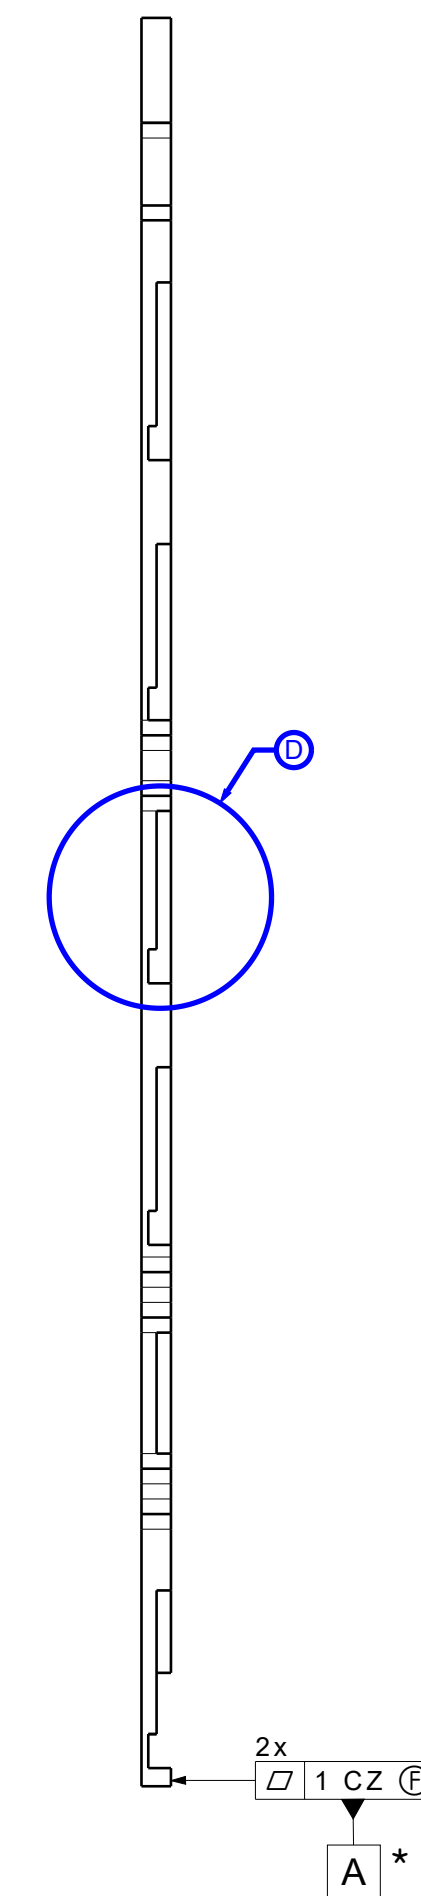


Vue de face
Echelle : 1:1

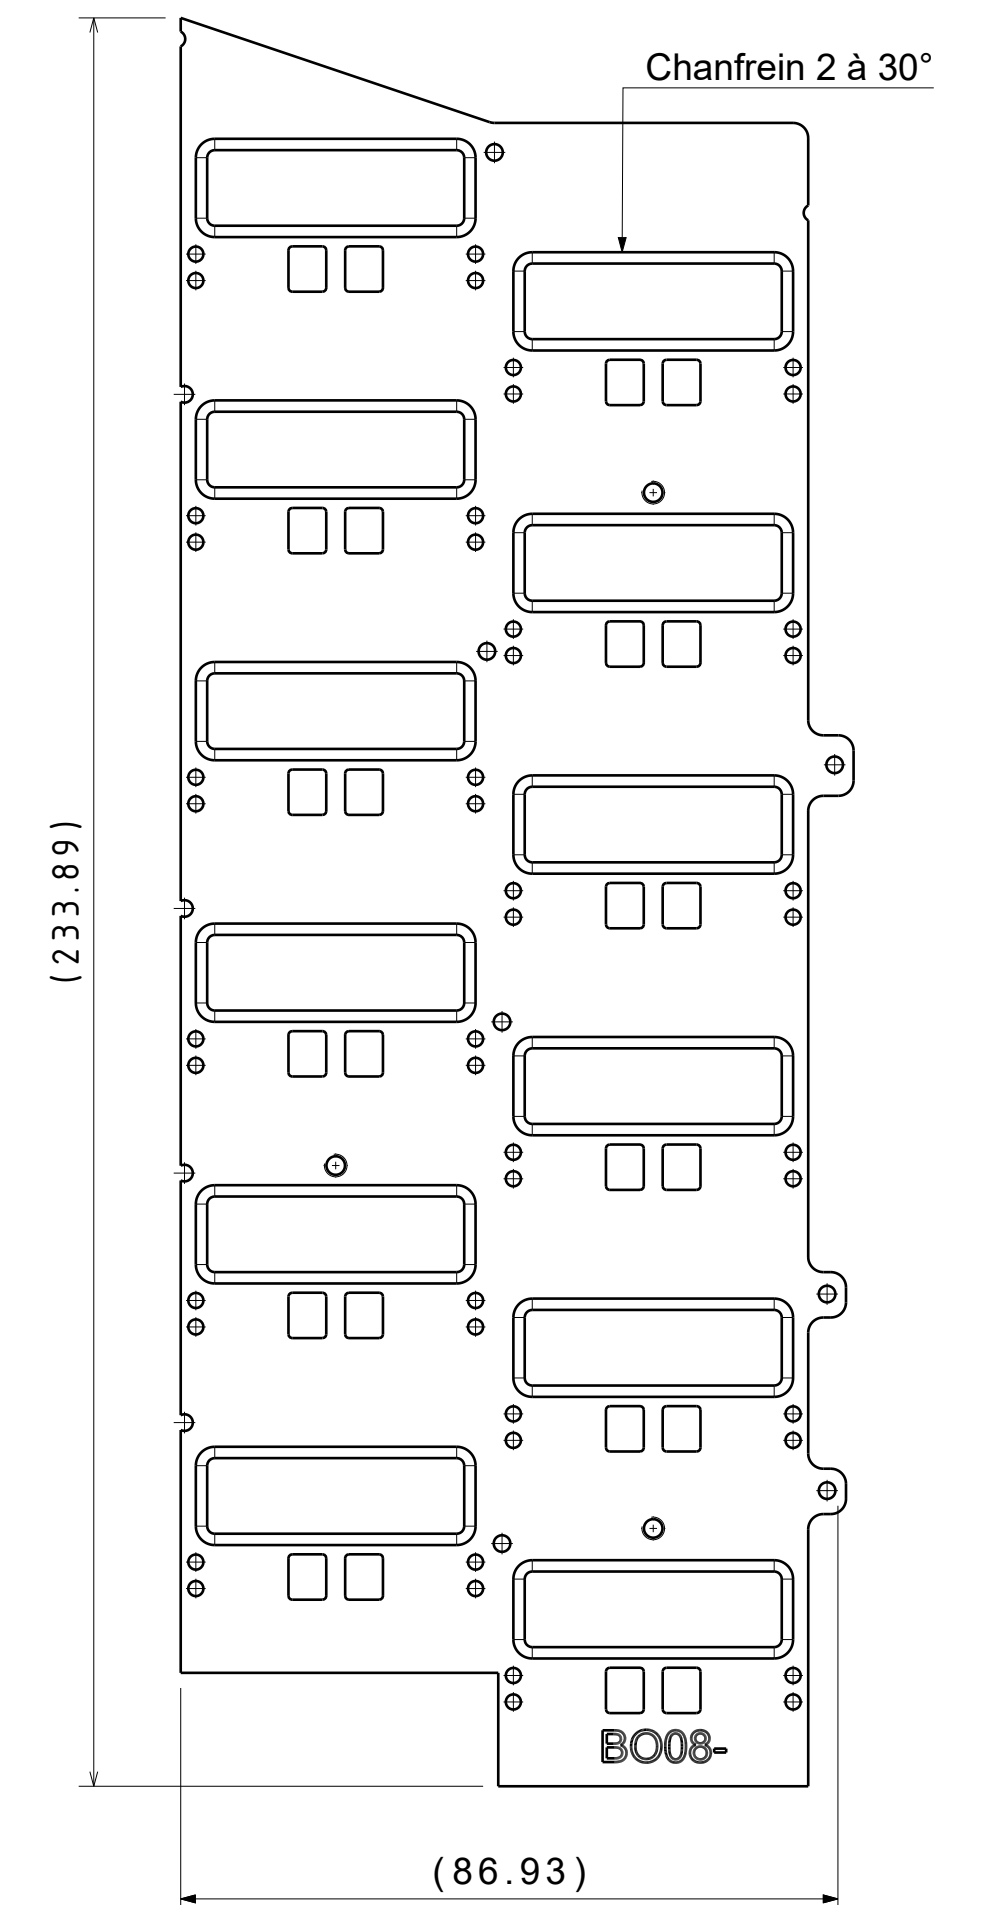

Détail D
Echelle : 2:1

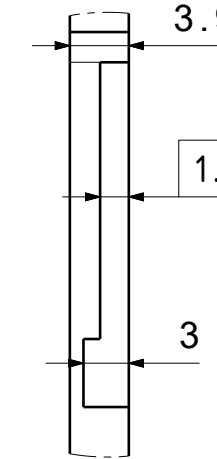

Détail E
Echelle : 5:1

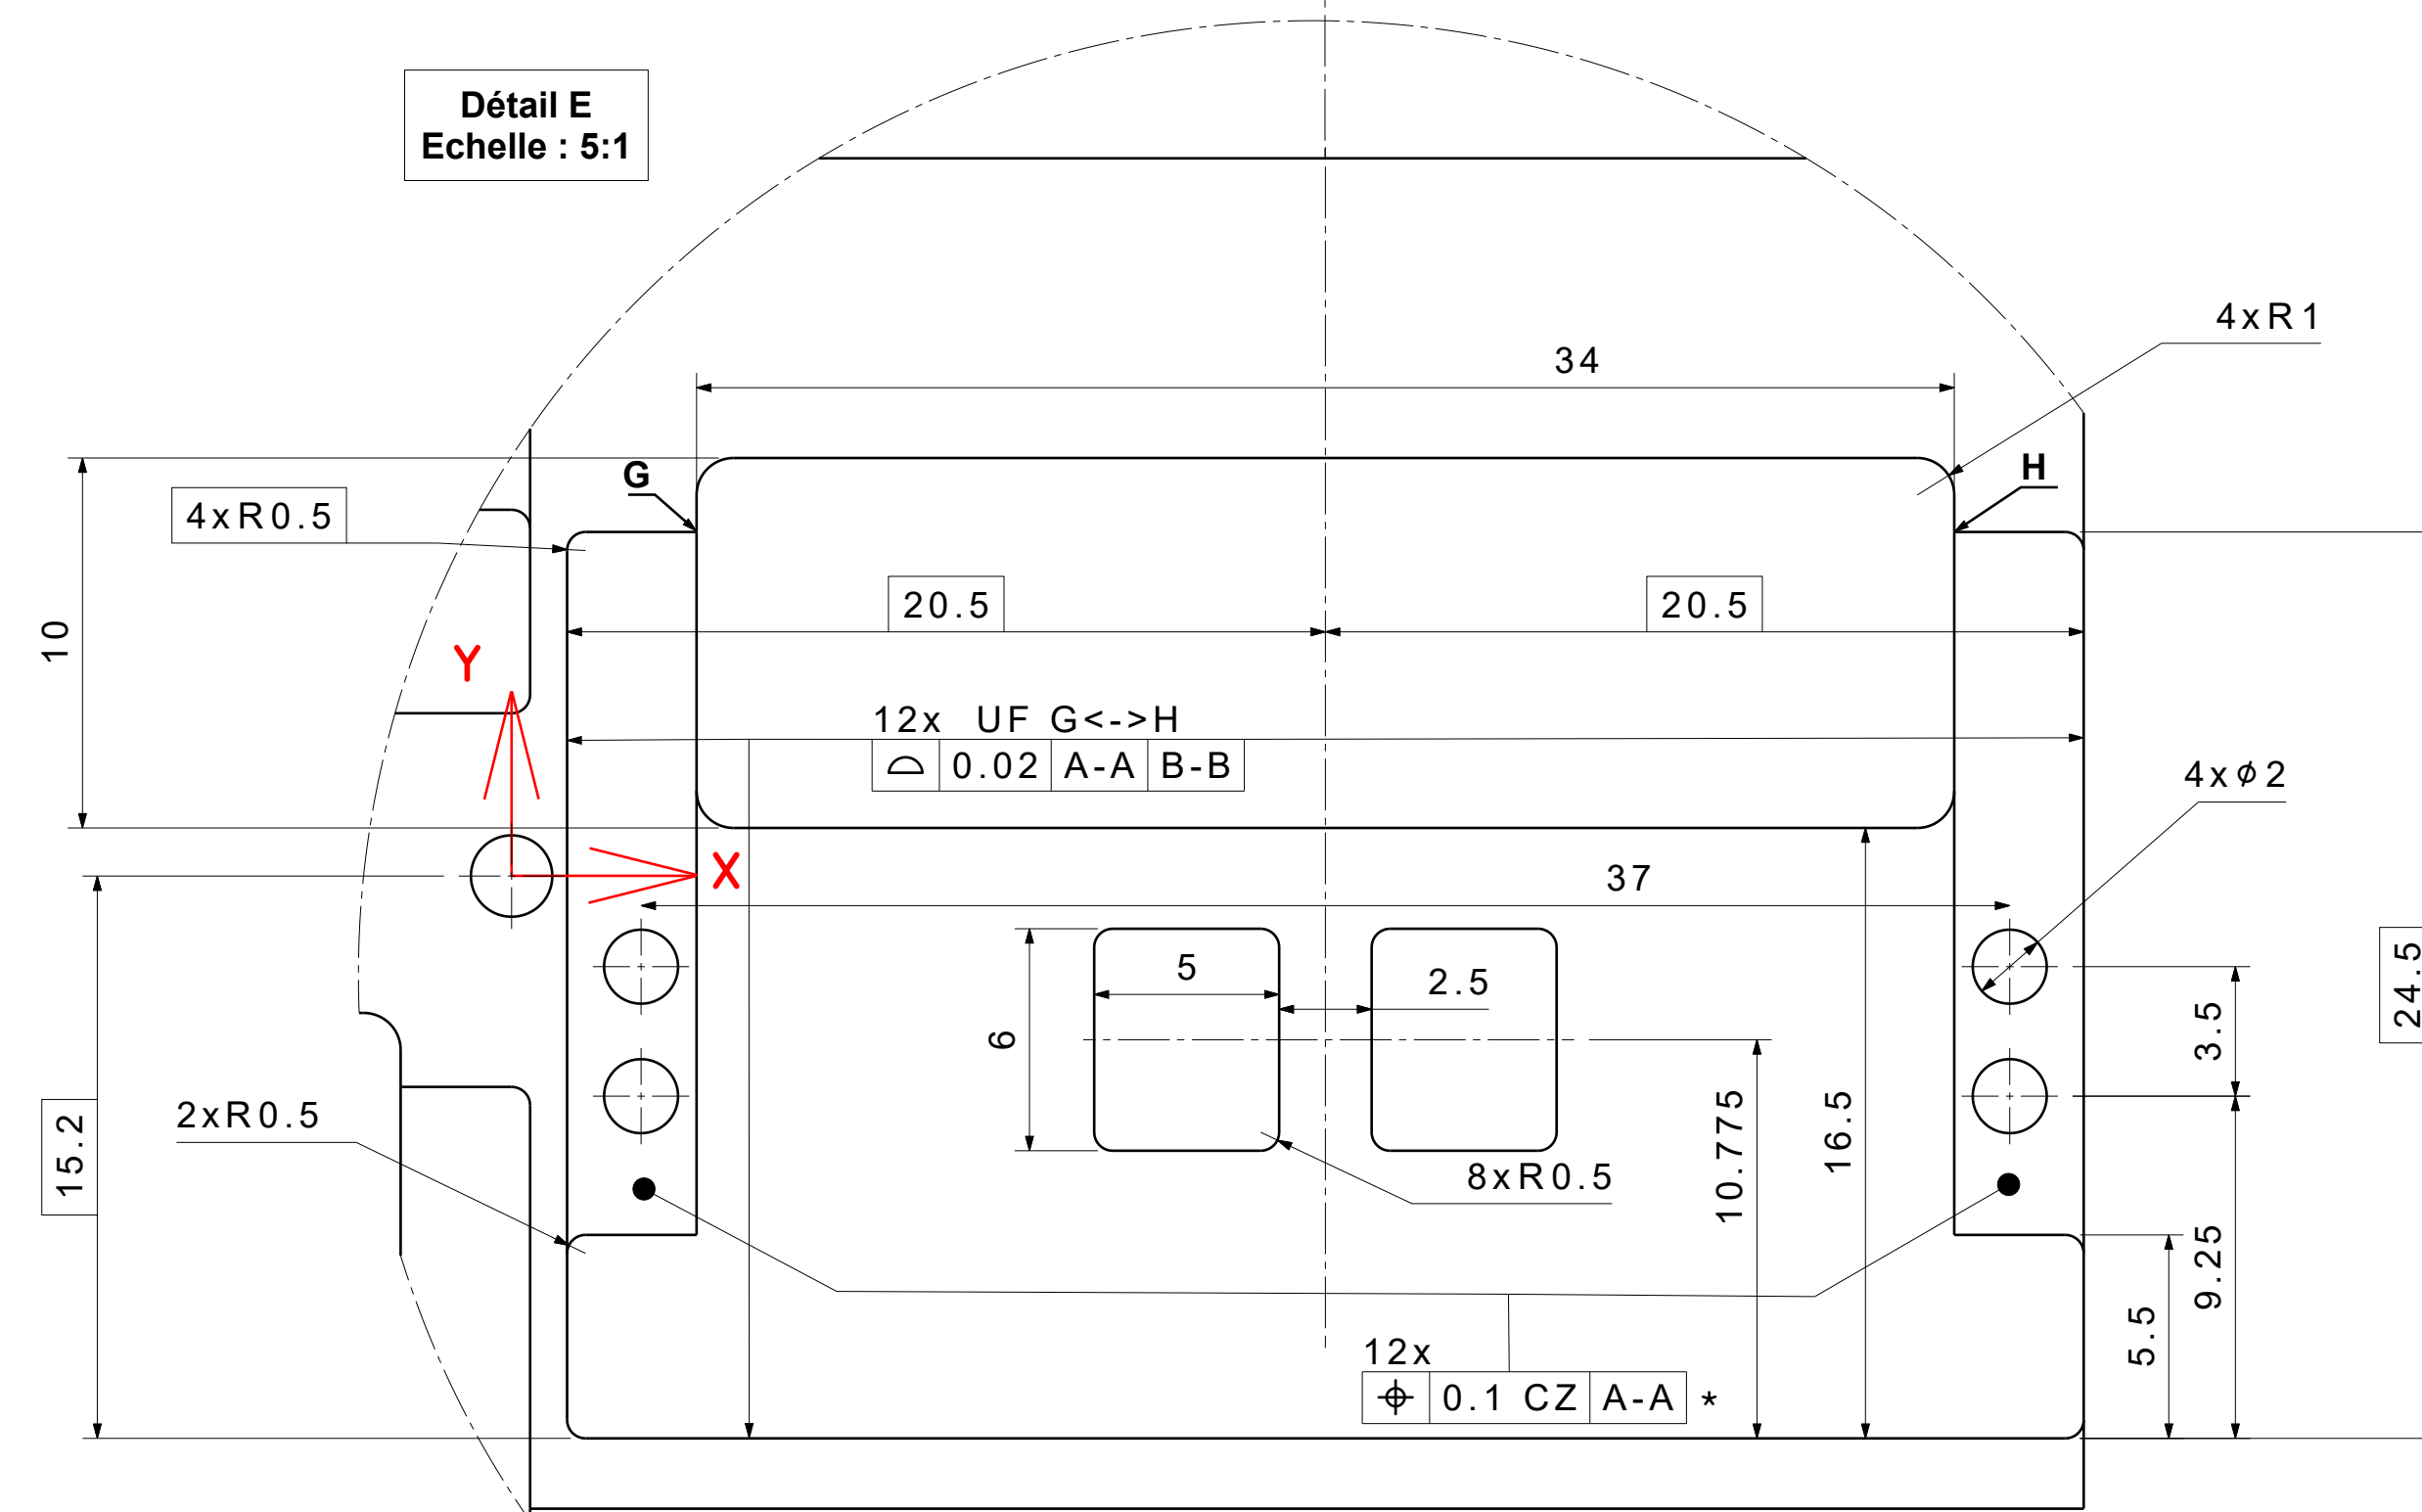

Tolérances générales / General tolerances :
- Dimensionnelles / Dimensional : ISO 2768-1 : f
- Géométriques / Geometric : ISO 22081

0,1 A-A B-B

Dimensions théoriques exactes conformément au modèle CAO
Exact theoretical dimensions as CAD model
HGTD-BO08SU D1

MATIERE :		MASSE :		RUGOSITE : RA 1.6	
PROJET :		NB PIECE :		ID 2D :DRW--CV6-00153372-CNRS	
DOSSIER :		HGTD-BO08SU		ID 3D :PRD--CV6-00980848-CNRS	
				REVISION :	
				CREE PAR: dlaporte	
				VALIDE PAR:	
Atrium - 1020772		Ref 3D : HGTD-BO08SU		FORMAT A1	
				Echelle 1:1	
				Indice D.1	

* Condition de contraintes : ISO-10579-NR
La pièce est plaquée face A sur un marbre avec toutes les vis M2.
Le couple de serrage des vis est de 0,05 Nm
* Stress Condition: ISO-10579-NR
The piece is A-side plated on a marble with all M2 screws.
The tightening torque of the screws is 0,05 Nm

D.1	Glue surface : height and tolerances changes	D. Laporte	22/09/2025
C	Capacitors windows modifications	D. Laporte	02/05/25
B			
A	Création		
Révison	Modification	Validé par	Date