



Vue isométrique
Echelle : 1:1

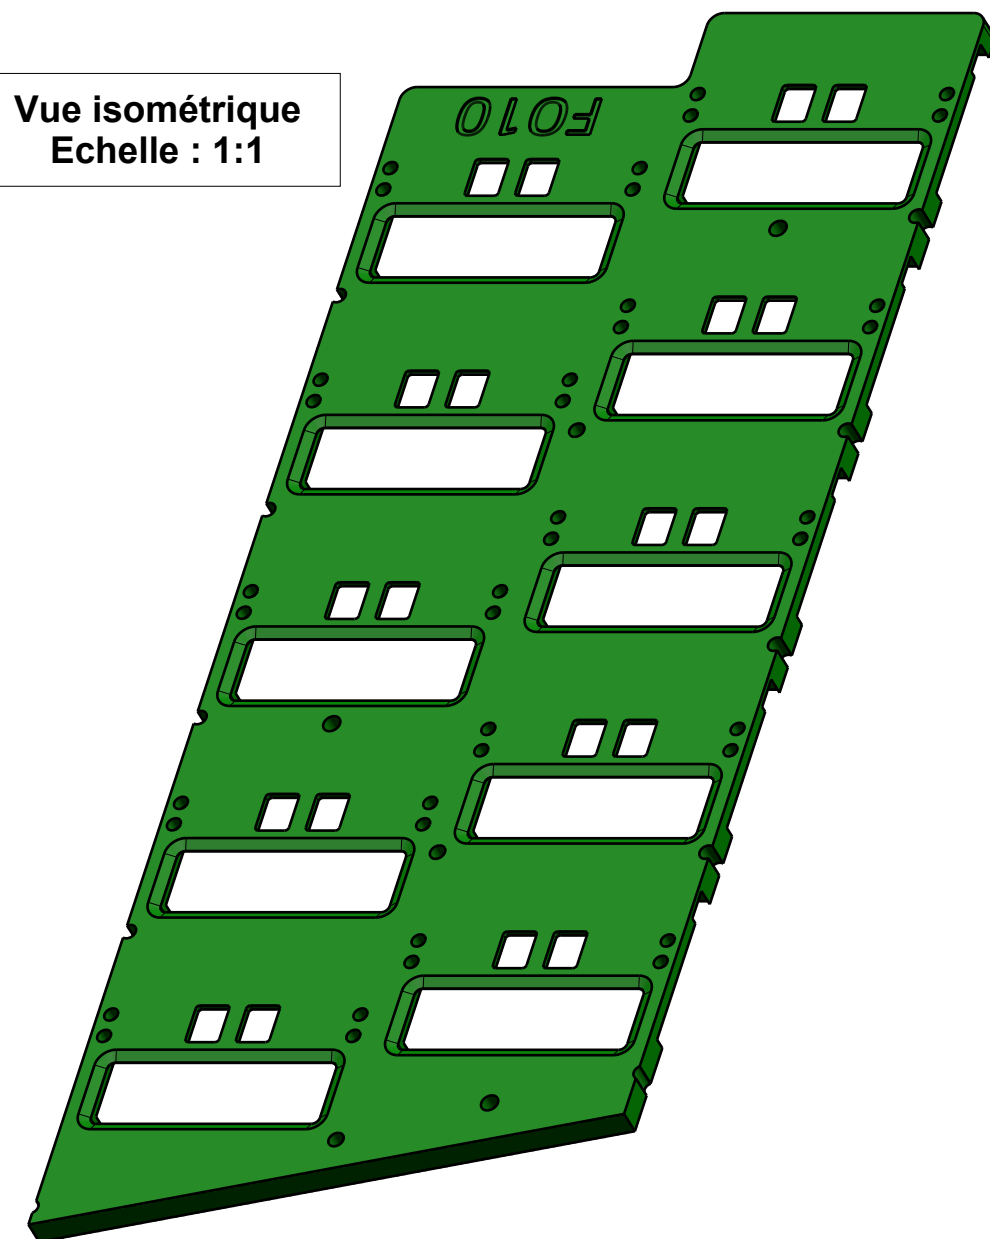

Vue isométrique
Echelle : 1:1

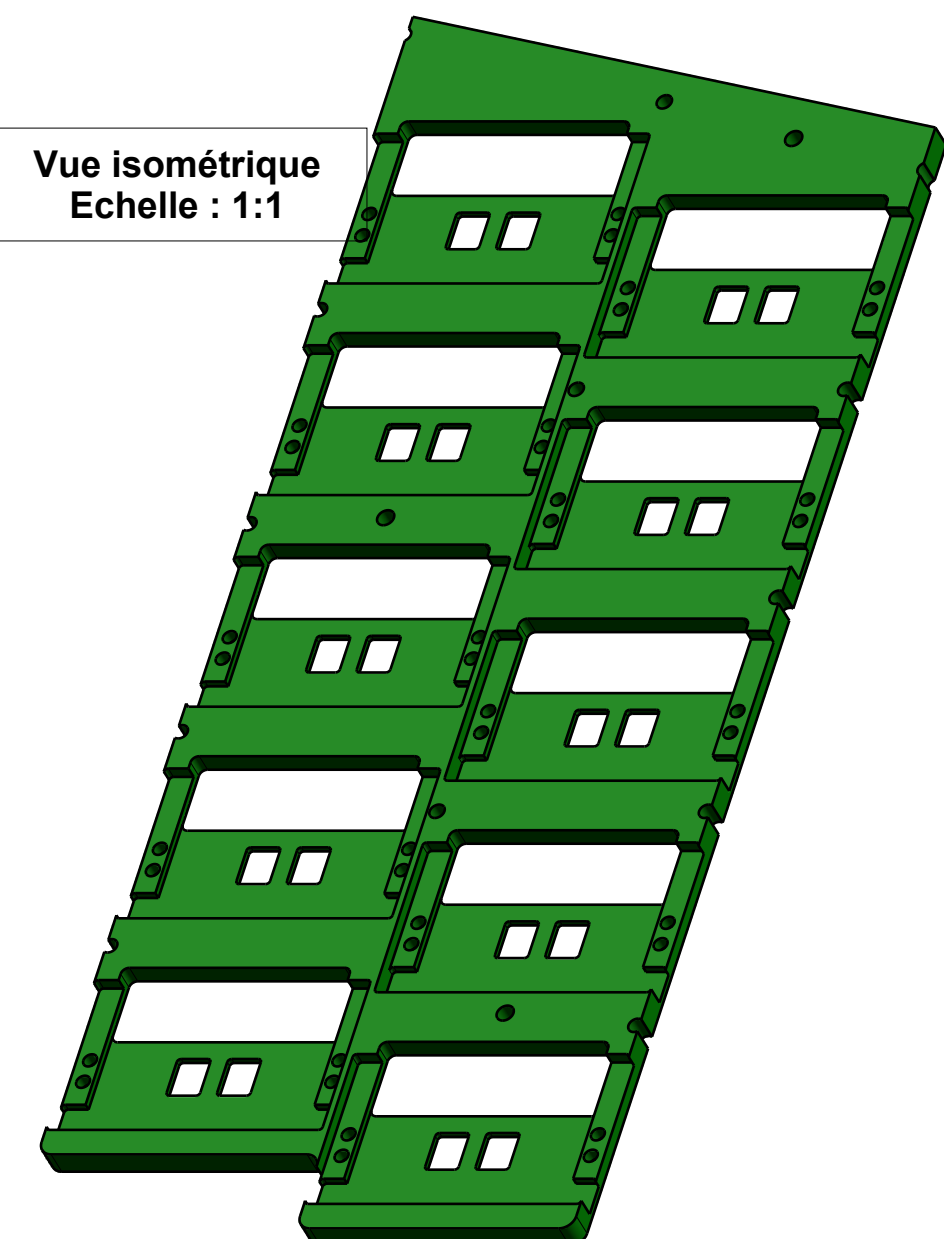


13x Ø 2.2 H10 (+0.04 / 0) (E)

REF.	X	Y
1	0	0
2	40	-35
3	-42	-22
4	-42	13
5	40	0
6	40	35
7	-42	47
8	0	69
9	40	69
10	-42	82
11	-43	127
12	-1	116
13	41	105




B

3xM3traversant/throught

REF.	X	Y
a	20	-33
b	-22	48

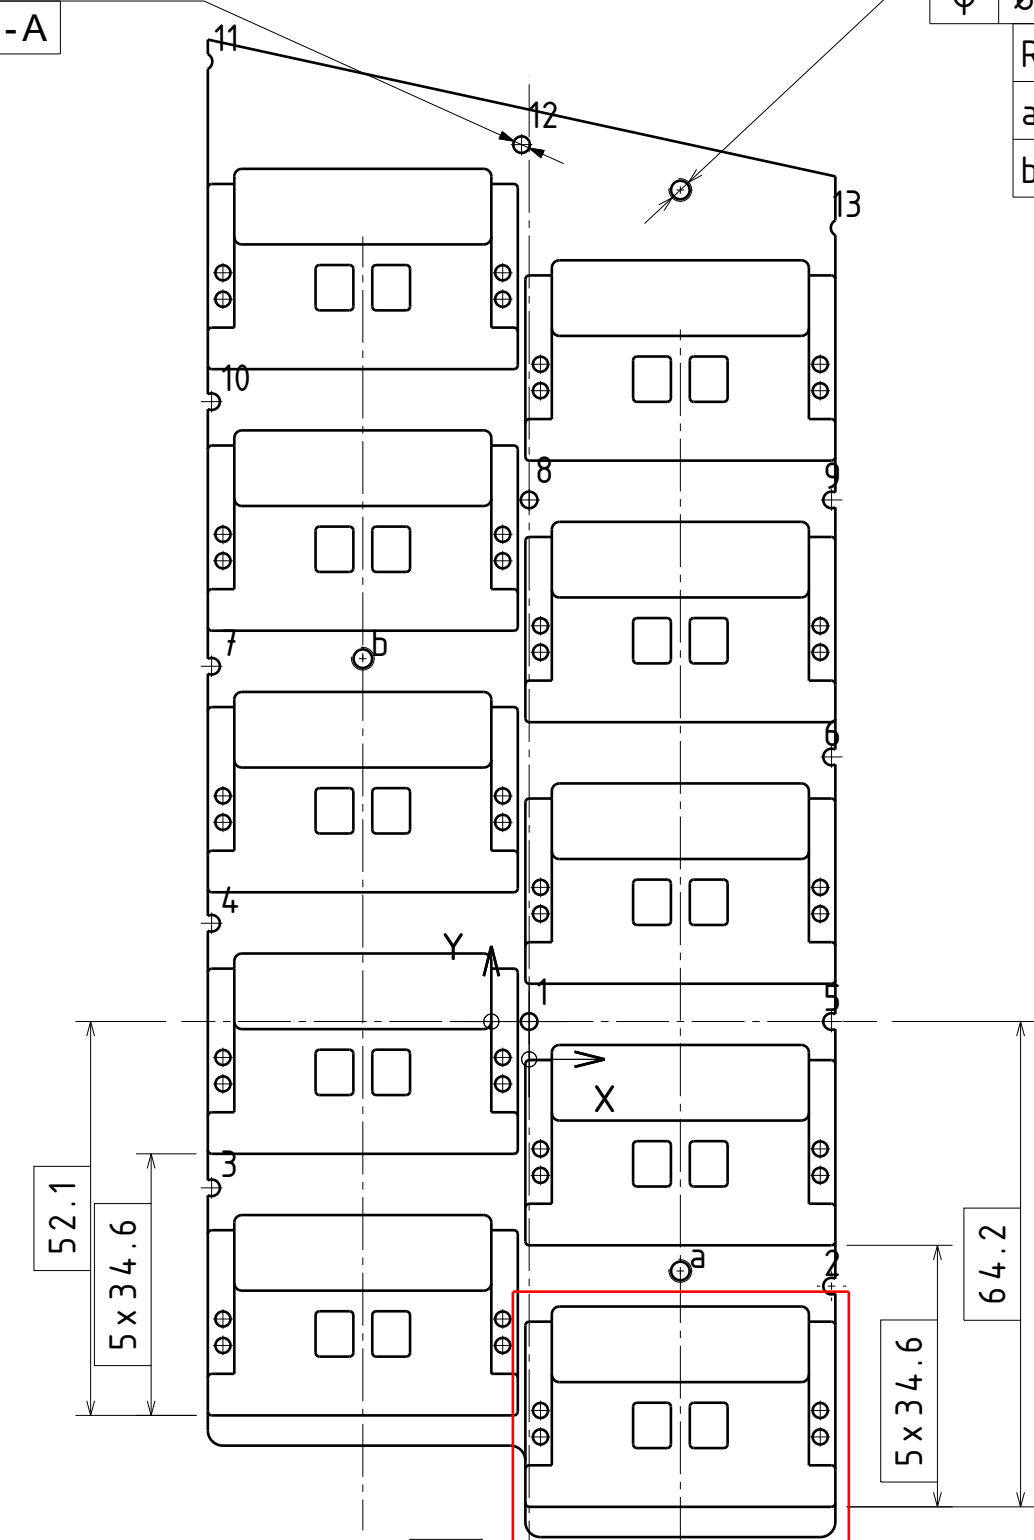

Détail E
Echelle : 3:1

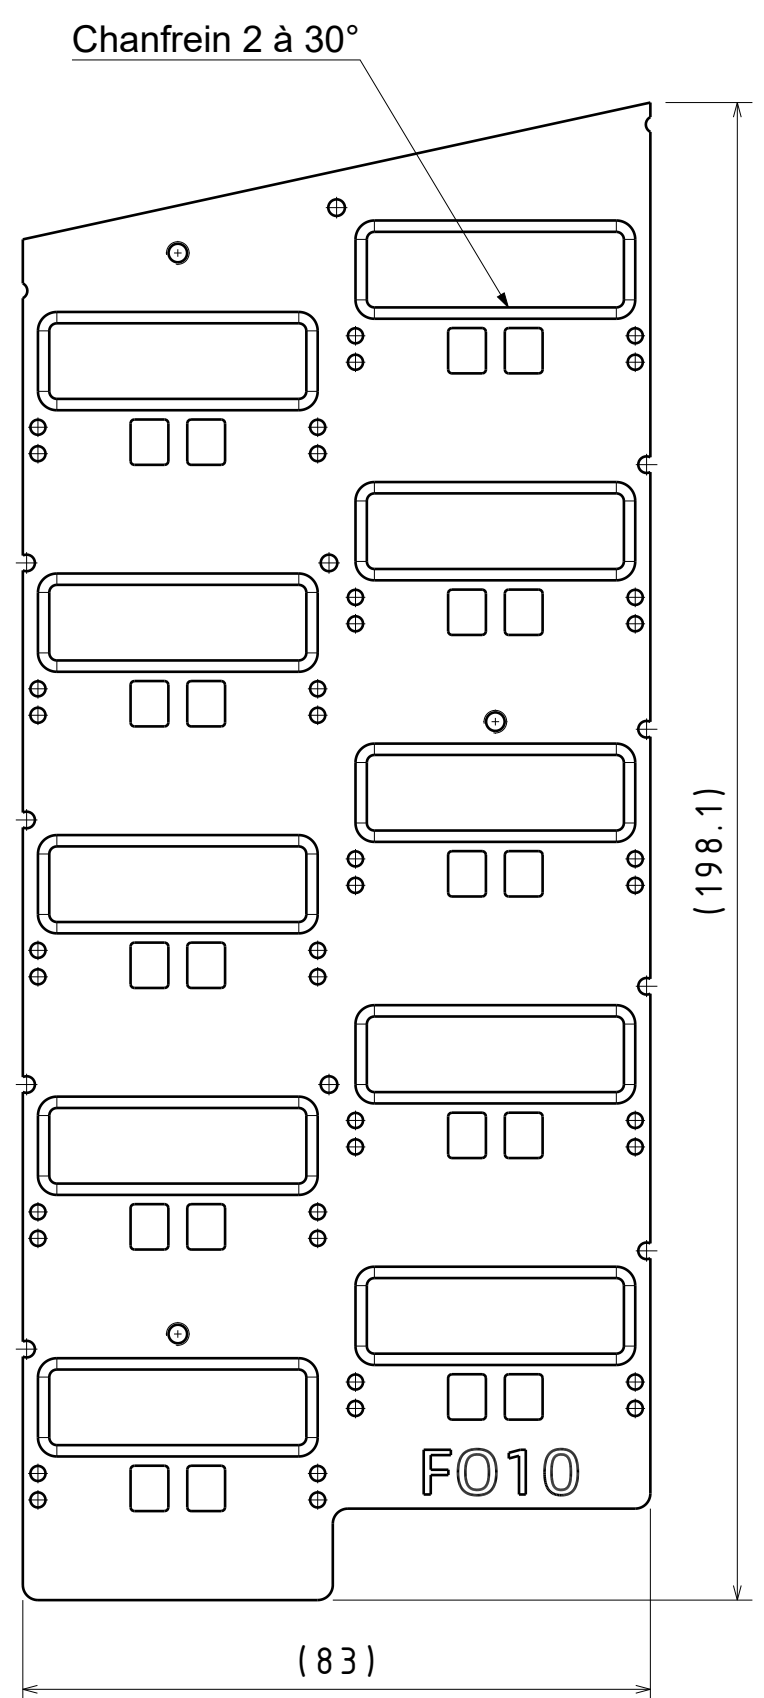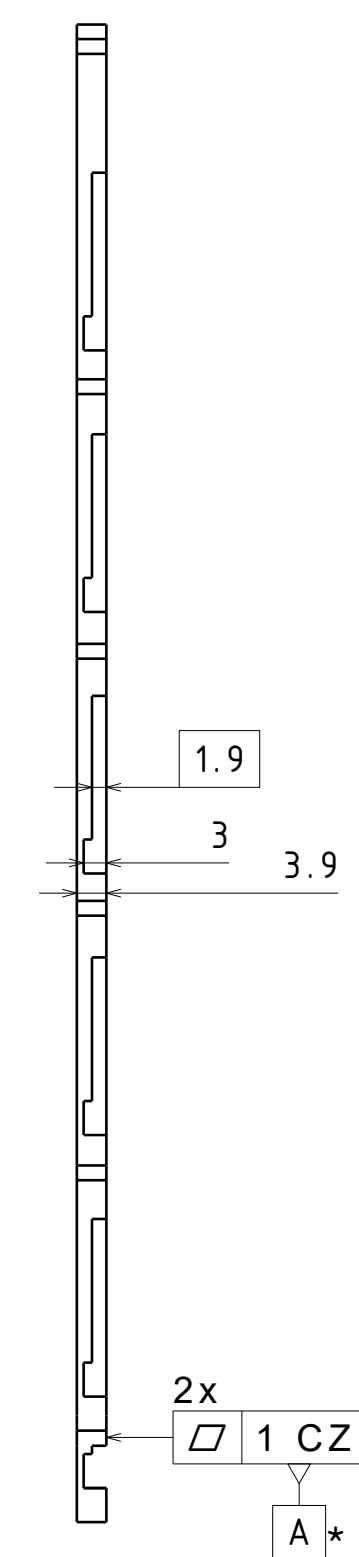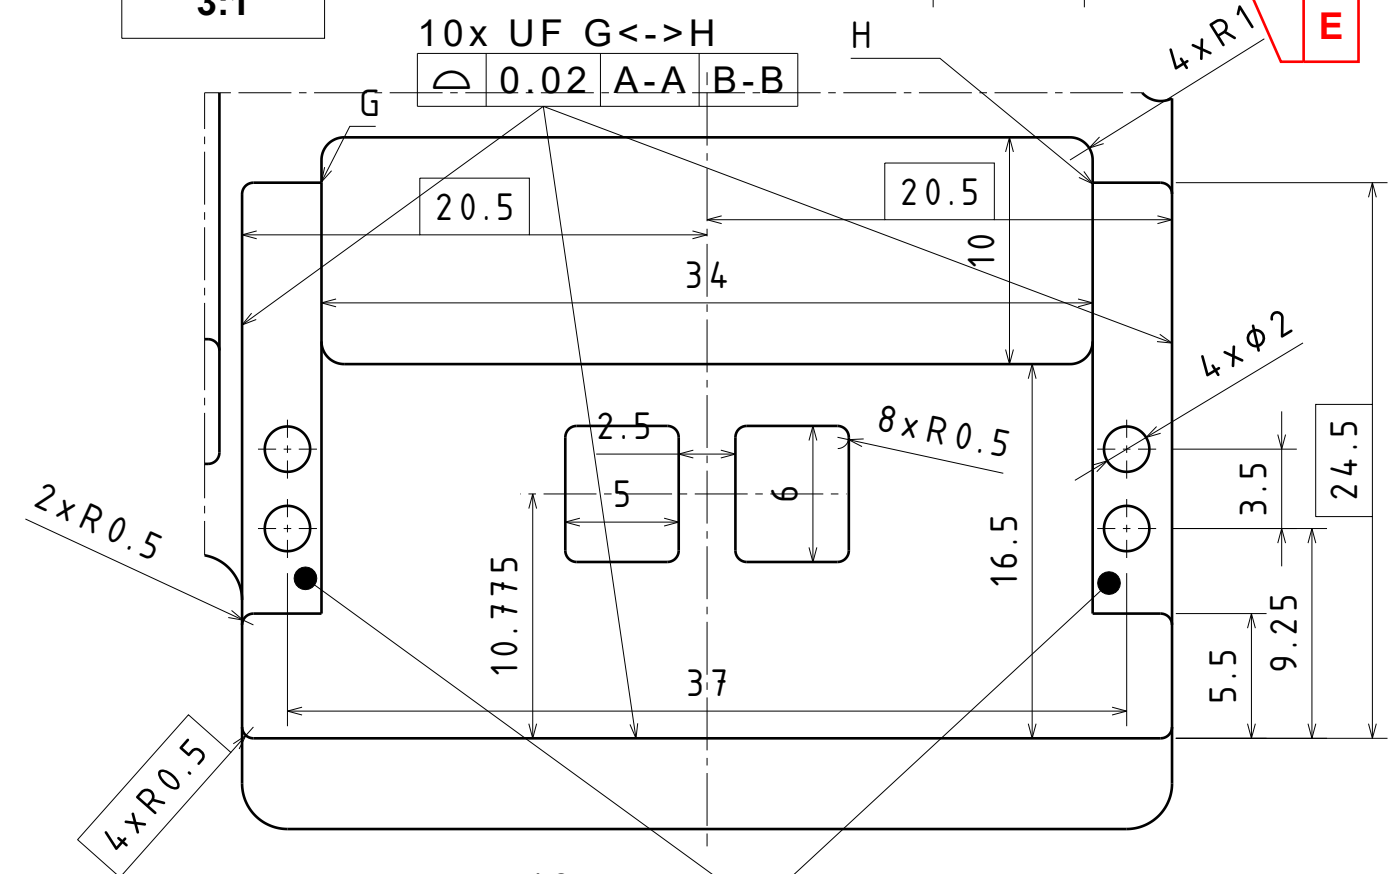

* Condition de contraintes : ISO-10579-NR
La pièce est plaquée face A sur un marbre avec toutes les vis M2.
Le couple de serrage des vis est de 0,05 Nm


* Stress Condition: ISO-10579-NR
The piece is A-side plated on a marble with all M2 screws.
The tightening torque of the screws is 0,05 Nm

Révison	Modification	Validé par	Date
C.1	Glue surface : height and tolerances changes	D. Laporte	23/09/2025
B	Capacitors windows modifications	D. Laporte	02/05/2025
A	Création	D. Laporte	16/10/2024

Tolérances générales / General tolerances : ISO 22081
Tolérances générales dimensionnelles / General dimension tolerances : ISO 2768-1-f

0,1 A-A B-B

Dimensions théoriques exactes conformément au modèle CAO
Exact theoretical dimensions as CAD model
HGTD-FO10SU C1



LPNHE
Barre 12-22, 1er étage
4 Place Jussieu
75252 Paris cedex 05

REPRODUCTIONS INTERDITES SANS AUTORISATION LOI DU 11.03.57

MATIERE :	MASSE :	RUGOSITE : RA 1.6	TOL. GENERALE : ISO 2768 1 K
PROJET : HGTD		ID 2D :DRW--CV6-00148631-CNRS	
DOSSIER :		ID 3D :PRD--CV6-00017771-CNRS	
NB PIECE :		CREATION : 19/07/2024	
HGTD-FO10SU		REVISION :	
		CREE PAR: dlaporte	
		VALIDE PAR:	
Atrium - 1022805	Ref 3D : HGTD-FO10SU	FORMAT A2	ECHELLE 1:1
		INDICE	C.1