
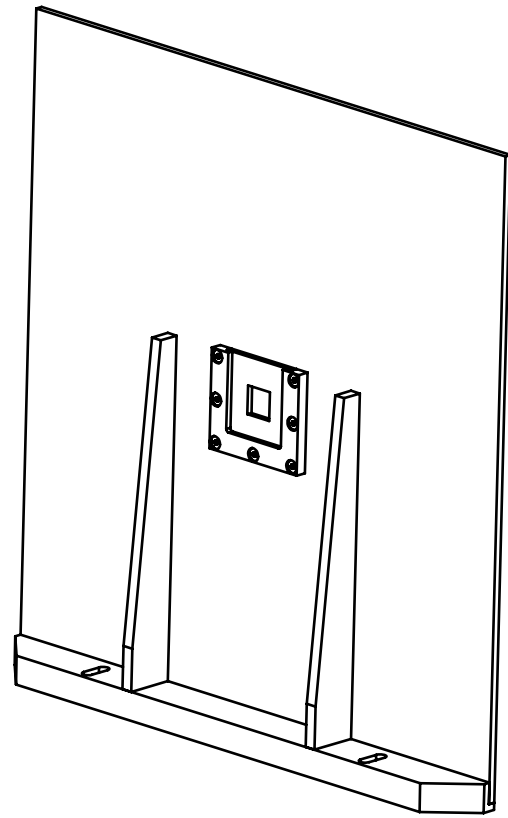
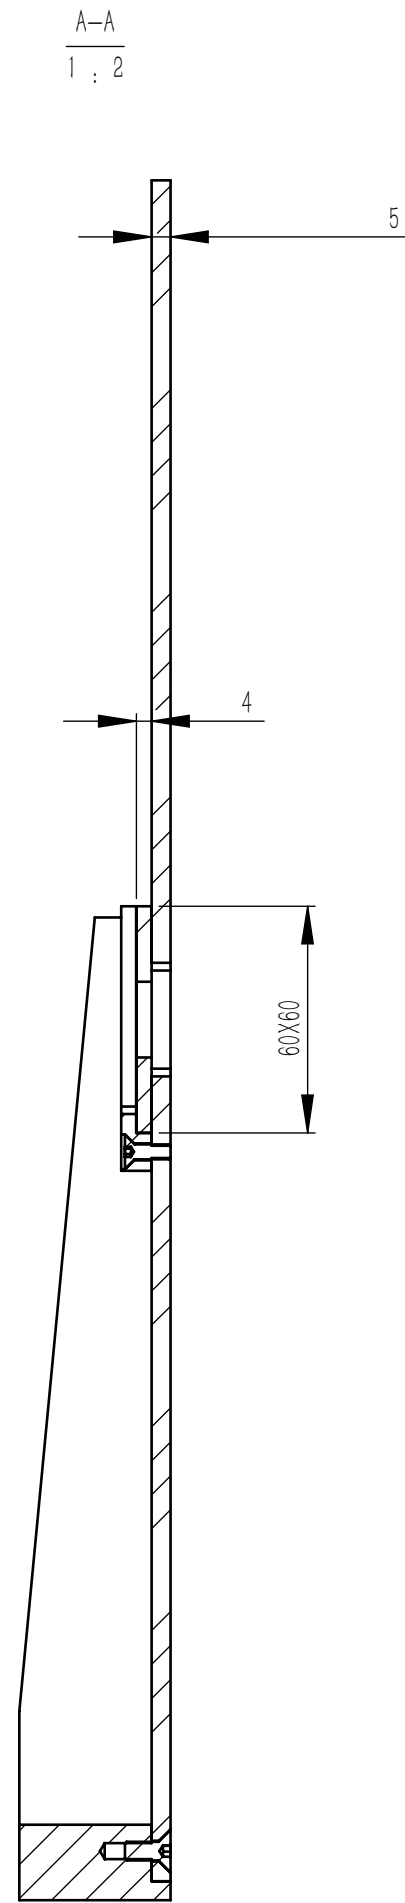
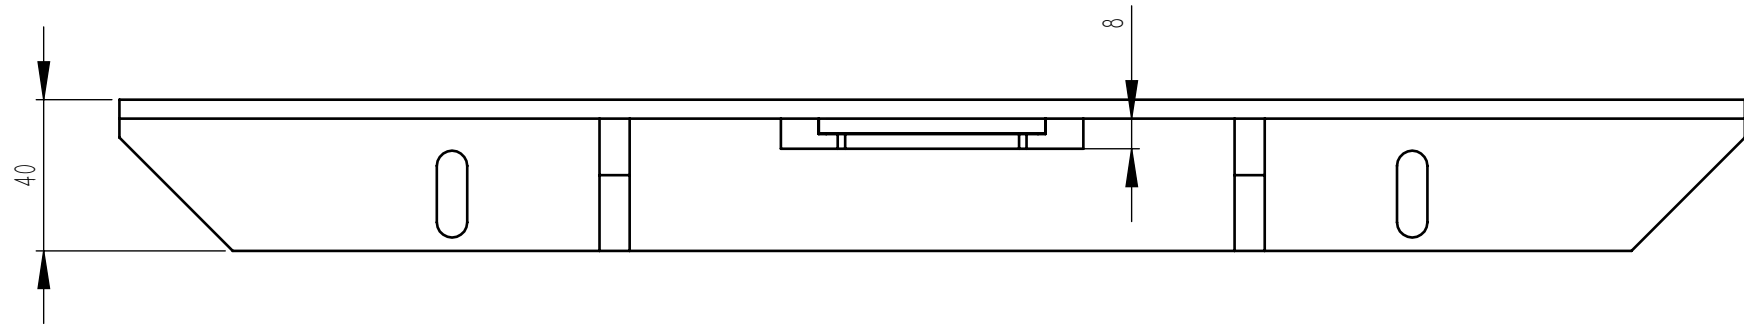


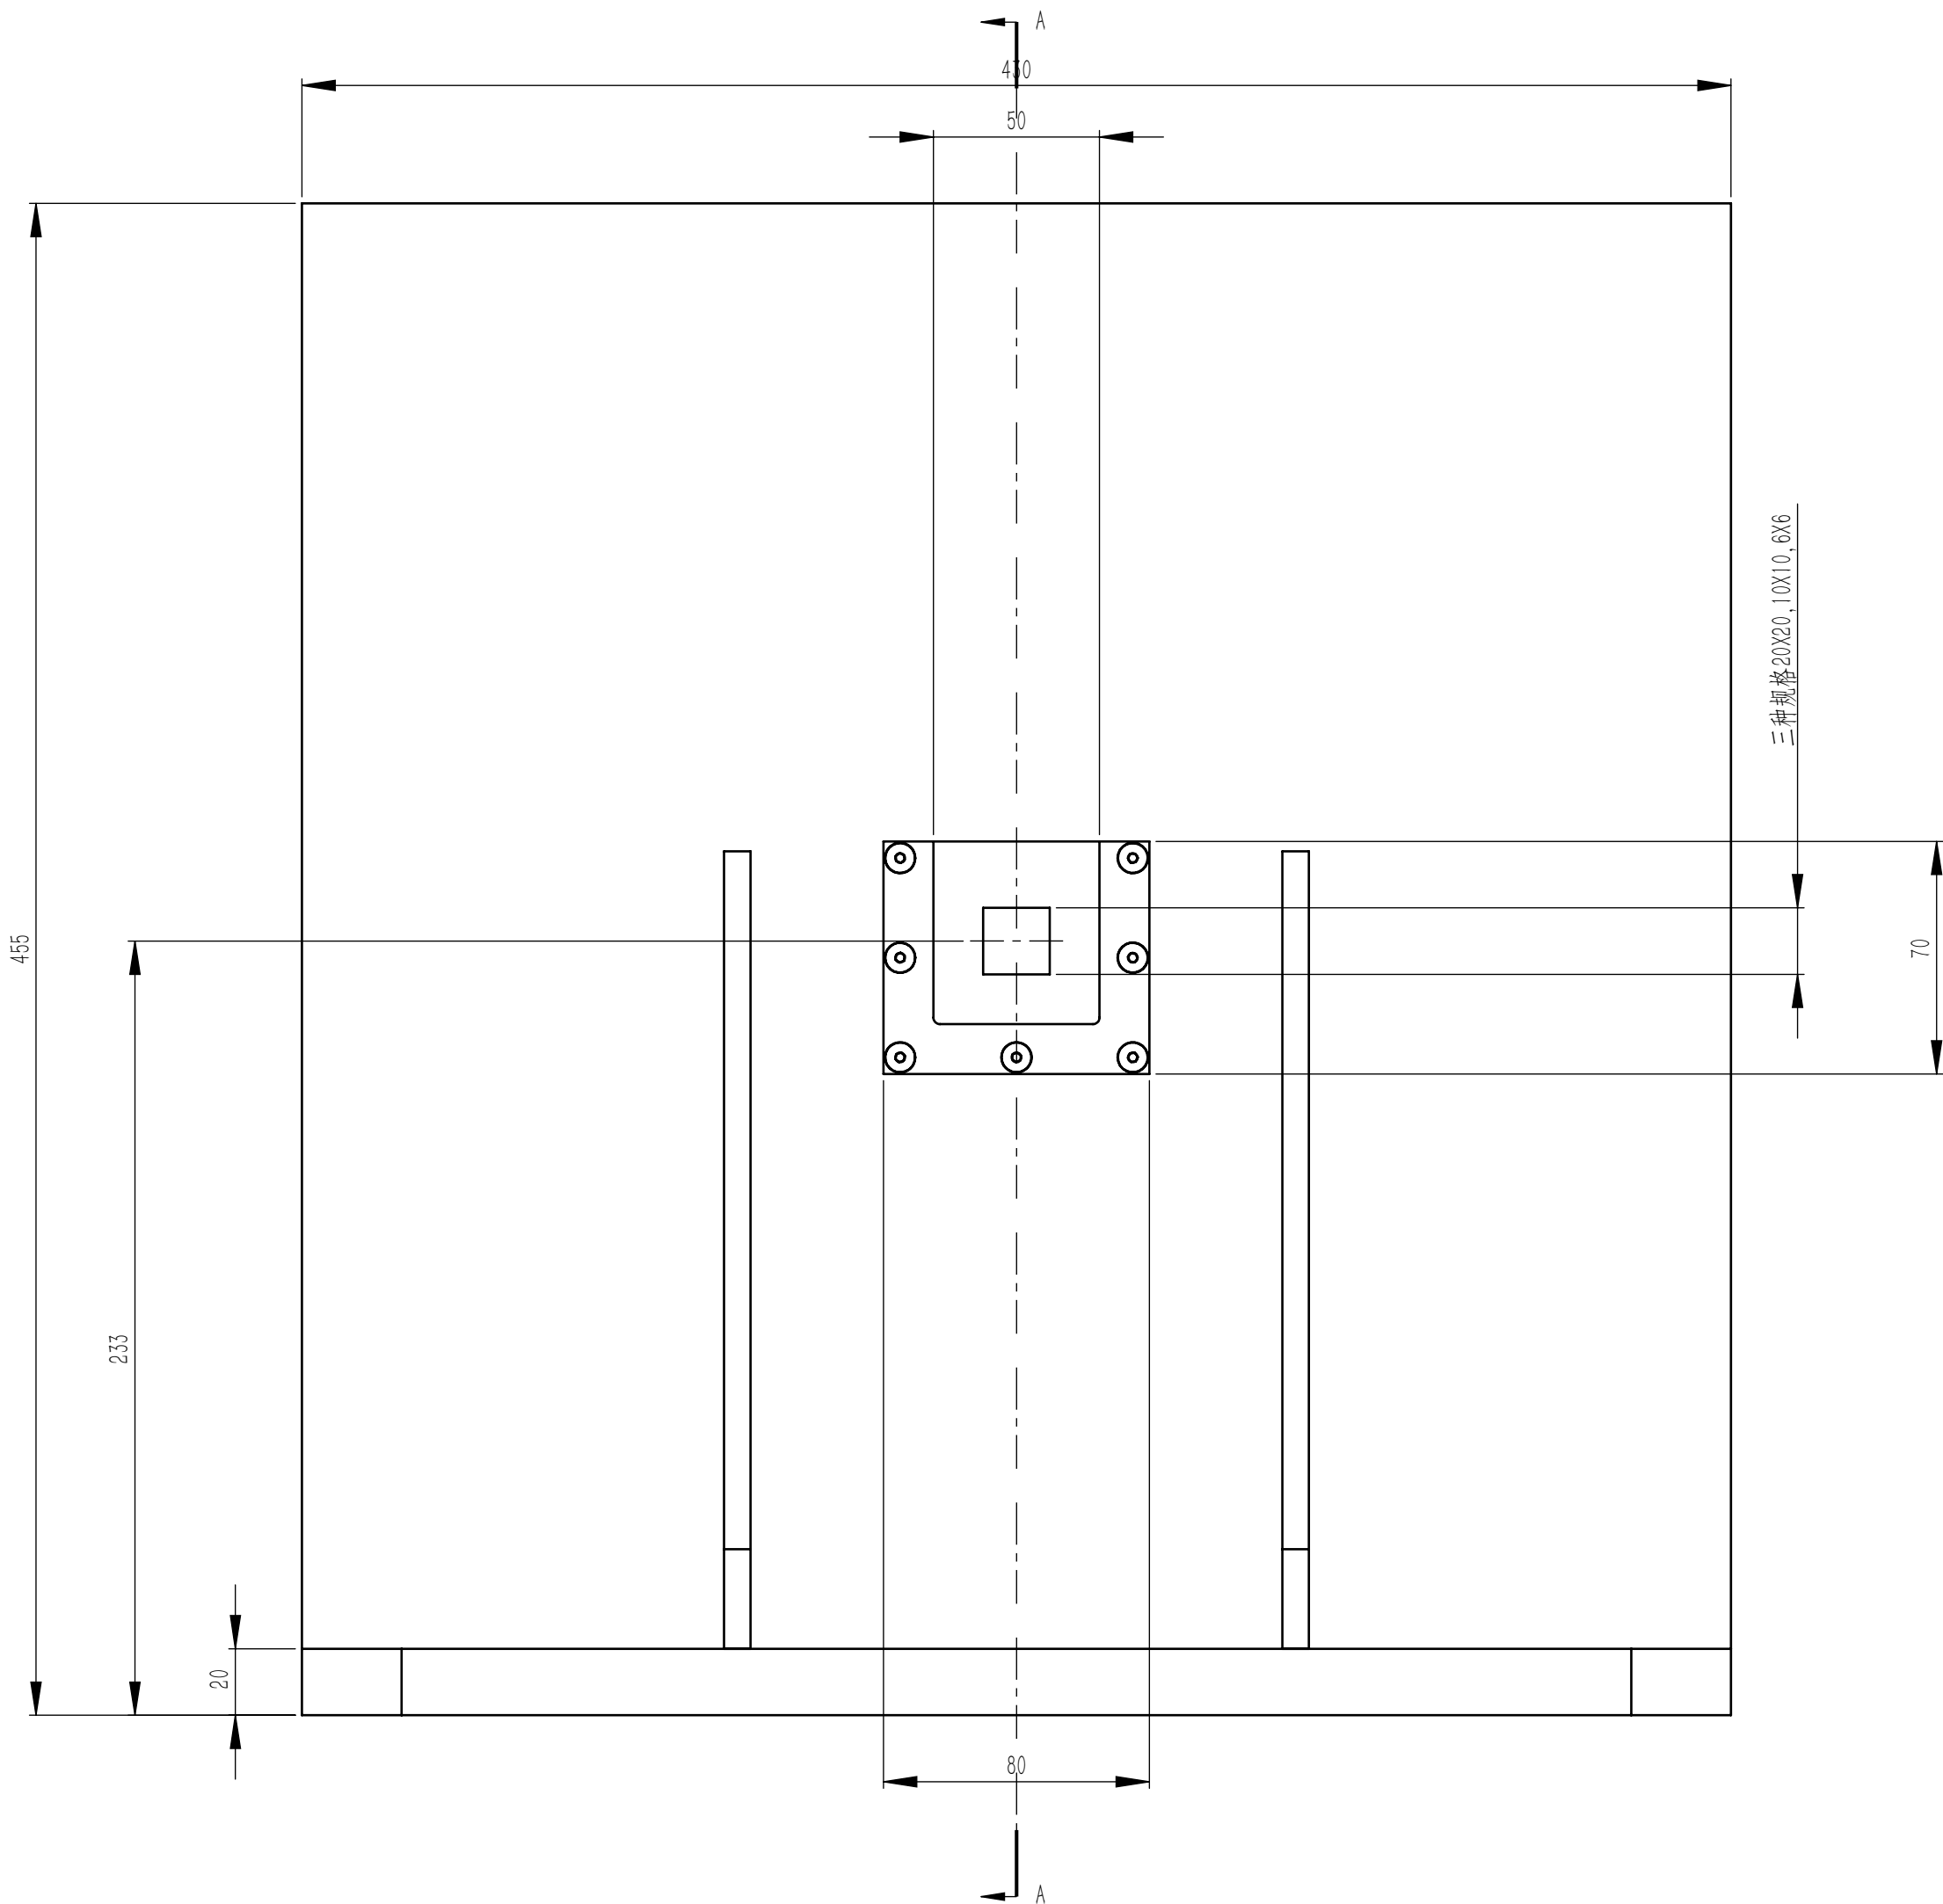

- 技术要求:
1. 高压谱仪狭缝屏蔽由底座和连接筋板、屏蔽挡板、插片及插片固定框组成
 2. 底座和连接筋板为铝合金6061材质，屏蔽挡板和插片固定框为硼铝合金，插片为烧结B4C材质
 3. 插片制作3种规格，中心孔分别为20*20、10*10、6*6方孔
 4. 屏蔽挡板上连接螺钉需为硼铝合金

8	GB/T 70.1-2000	内六角圆柱头螺钉 M4×25	4	S30403		0	
7	GB/T 70.3-2008	内六角沉头螺钉 M5×12	5	S30403	0	0	
6	GB/T 70.3-2008	内六角沉头螺钉 M4×12	13	硼铝合金	0	0	
5	RS-HPND31-00-05	加强筋	2	6061-T6 (SS)	0.13	0.26	
4	RS-HPND31-00-04	插片固定框	1	硼铝合金	0.05	0.05	
3	RS-HPND31-00-03	插片	1	烧结B4C	0.03	0.03	
2	RS-HPND31-00-02	狭缝屏蔽底座	1	6061-T6 (SS)	0.77	0.77	
1	RS-HPND31-00-01	狭缝屏蔽挡板	1	硼铝合金		0	
序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注
中国科学院高能物理研究所 IHEP-CSNS							版本号
设计			高压谱仪狭缝插片屏蔽组件		计算机文件名	绘图软件名	
制图						SolidWorks2012	
校核					数量	重量	图幅
审核					1	Kg	1:5
会签					共1页	第1页	A2
审定			组件		未注尺寸公差按GB/T 1804-m级制造		
批准					未注形位公差按GB/T 1184-k级制造		