


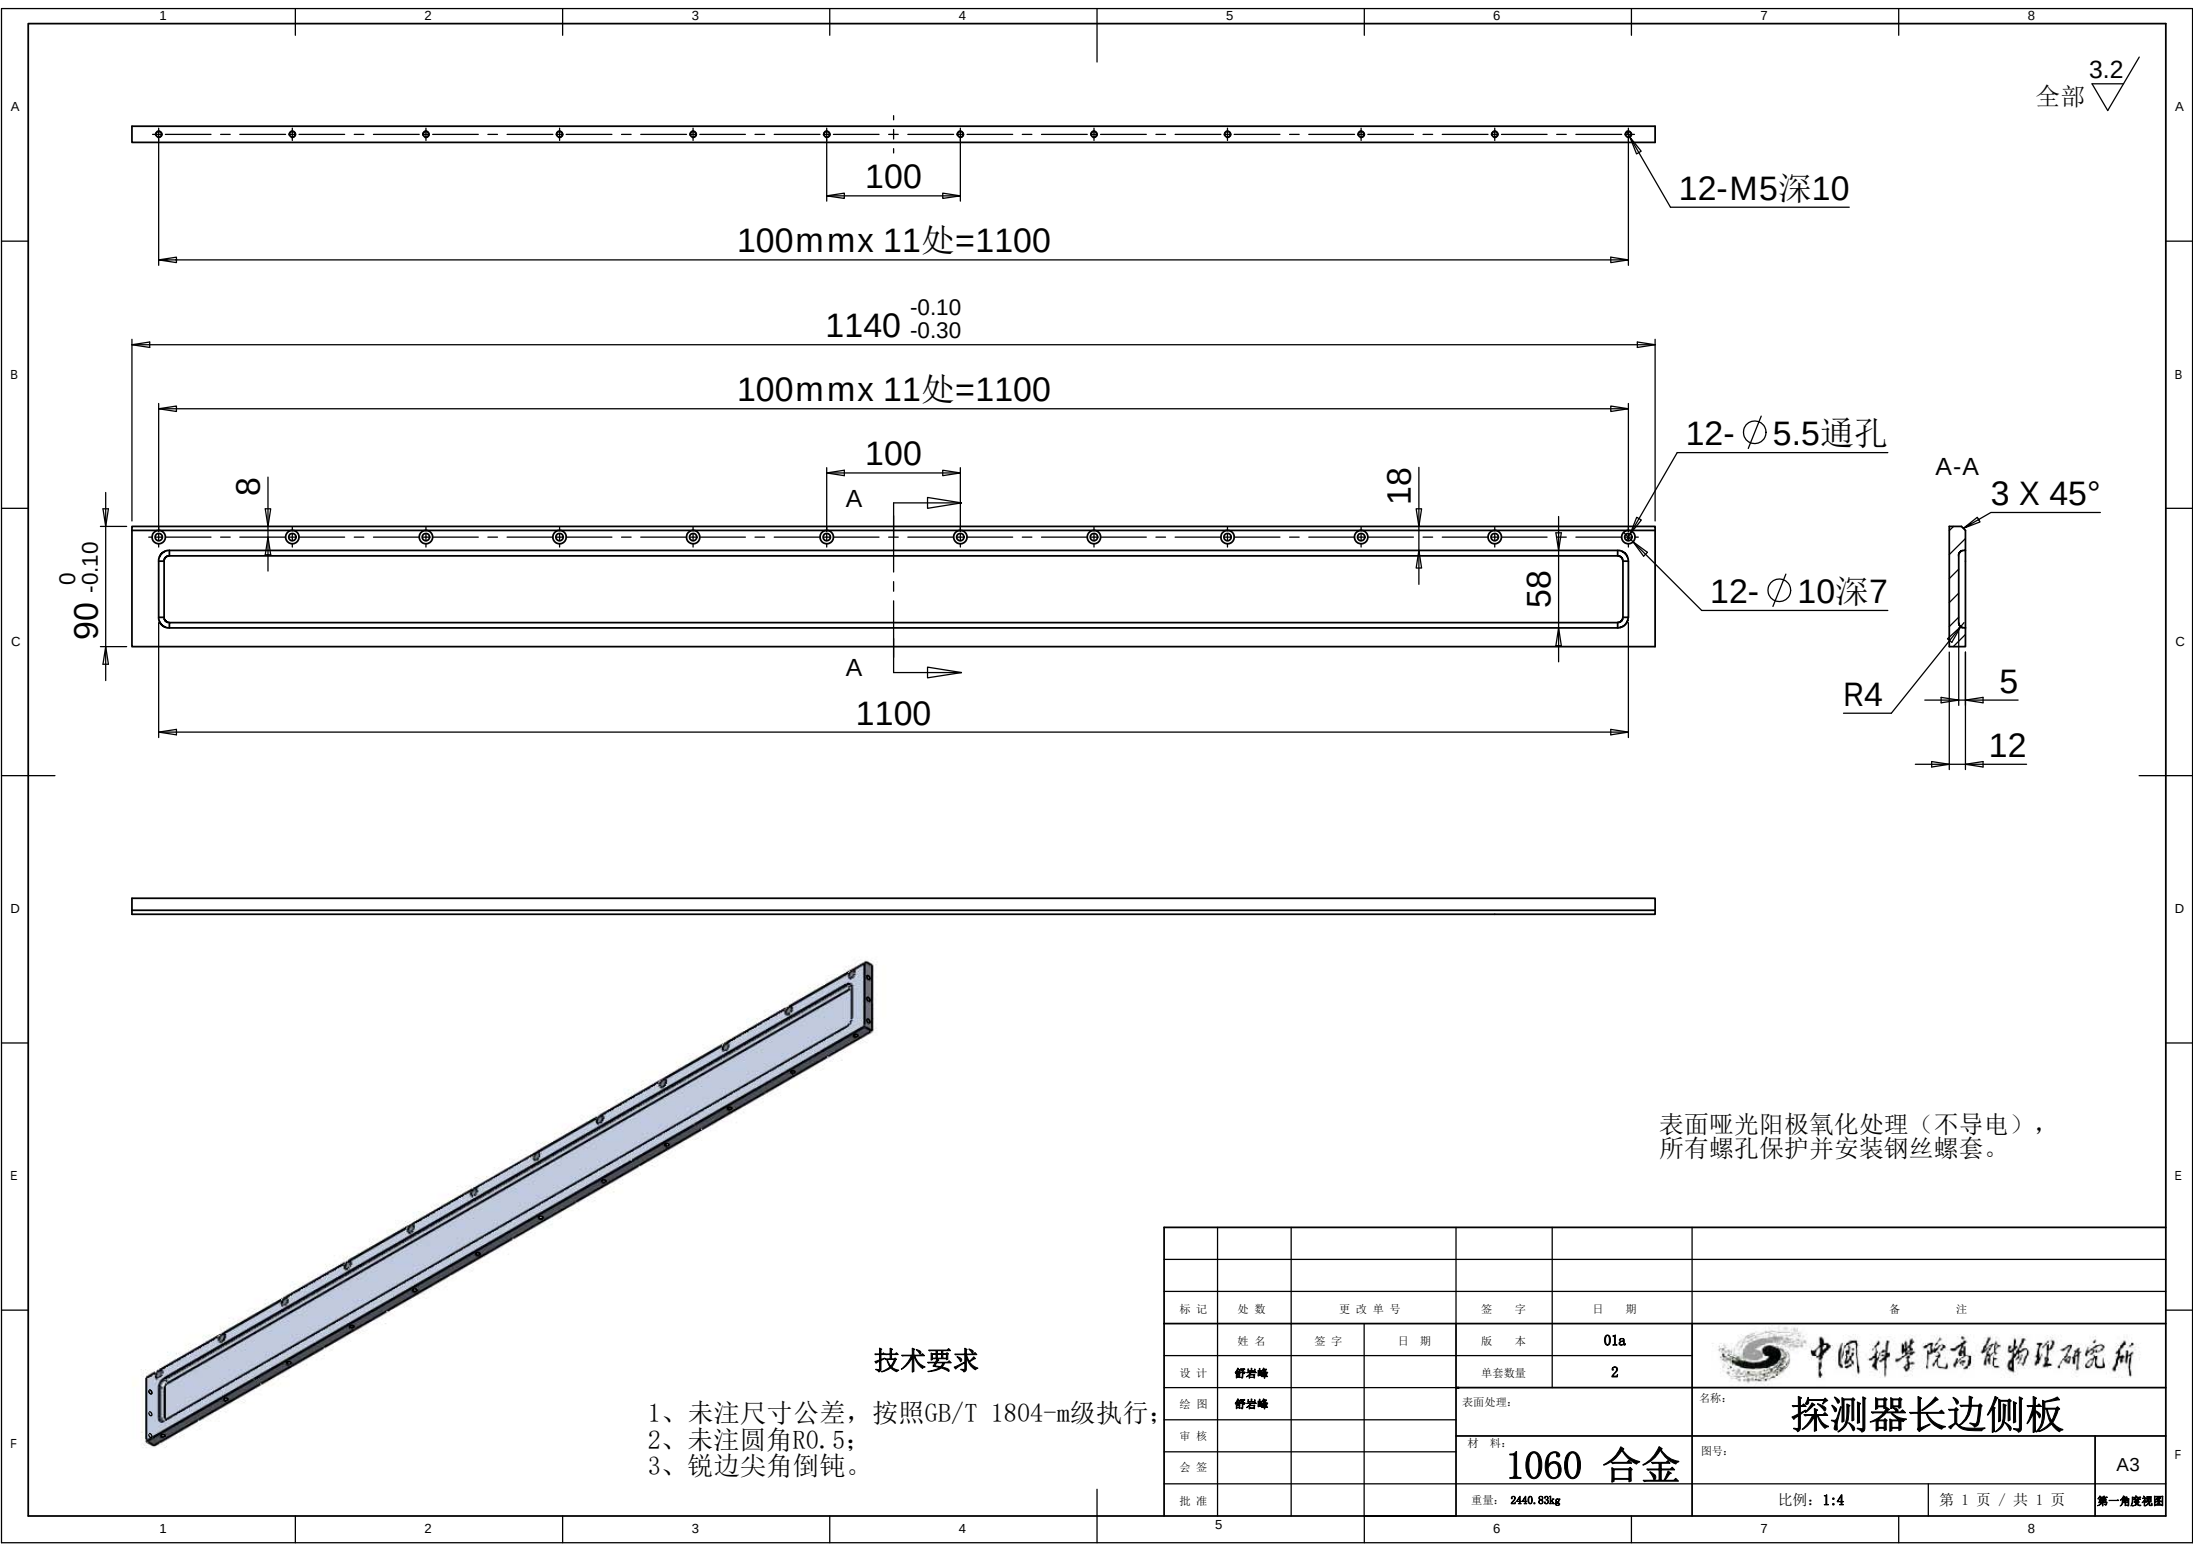

全部 3.2

12-M5深10

100mmx 11处=1100

1140<sup>-0.10</sup><sub>-0.30</sub>

100mmx 11处=1100

12- Ø 5.5通孔

12- Ø 10深7

A-A 3 X 45°

R4 5 12

技术要求

- 1、未注尺寸公差，按照GB/T 1804-m级执行；
- 2、未注圆角R0.5；
- 3、锐边尖角倒钝。

表面哑光阳极氧化处理（不导电），  
所有螺孔保护并安装钢丝螺套。

|    |  |     |  |      |  |              |     |                                                                                                    |  |
|----|--|-----|--|------|--|--------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 标记 |  | 处数  |  | 更改单号 |  | 签 字          | 日 期 | 备 注                                                                                                |  |
| 设计 |  | 姓名  |  | 签字   |  | 版 本          | 01a |  中国科学院高能物理研究所 |  |
| 绘图 |  | 舒岩峰 |  |      |  | 单套数量         | 2   |                                                                                                    |  |
| 审核 |  |     |  |      |  | 表面处理：        |     | 名称：探测器长边侧板                                                                                         |  |
| 会签 |  |     |  |      |  | 材 料：         |     | 图号：                                                                                                |  |
| 批准 |  |     |  |      |  | 1060 合金      |     | A3                                                                                                 |  |
|    |  |     |  |      |  | 重量：2440.83kg |     | 比例：1:4                                                                                             |  |
|    |  |     |  |      |  |              |     | 第 1 页 / 共 1 页                                                                                      |  |
|    |  |     |  |      |  |              |     | 第一角度视图                                                                                             |  |